



170000128222



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0317

检 验 报 告

TEST REPORT

检 报 告 编 号	201900004370M
品 名 称	双极水®抗菌液
检 单 位	火人京创（北京）医疗器材有限公司

宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心
NINGBO ENTRY-EXIT INSPECTION AND QUARANTINE BUREAU TECHNICAL CENTER



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0317

宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心

检验报告

检 验 报 告 编 号	201900004370M
样 品 名 称	双极水®抗菌液
送 检 单 位	火人京创（北京）医疗器材有限公司
检 验 类 别	委托检验

2019年9月27日

宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心

声 明

- 1、本单位保证检测的公正性、独立性和诚实性，对检测结果负责，对委托方所提供的检测样品及在检测活动中所获得的国家秘密、商业秘密、技术秘密保密。
- 2、本报告无授权签字人签字及未盖本单位检验检测专用章无效。
- 3、本检验报告涂改、缺页、部分复印无效。
- 4、委托方若对本报告有异议，须在检验报告收到之日起15日内向本单位提出复核申请，逾期不予受理。
- 5、本单位接收的委托送检样品，其代表性、真实性和准确性由委托方负责。本报告的检测数据和结果仅对收到的样品负责。
- 6、本检验报告及检验单位名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
- 7、本检验报告一式四份，三份交送检单位，一份由本单位存档。

地址：宁波市高新区清逸路66号A幢 邮编：315048 电话：0574-87169368



170000128222

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0317宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心
检验报告

样品受理编号: 1900088391

报告编号: 201900004370M

第 1 页/共 3 页

样 品 名 称	双极水®抗菌液	商 标	双极水®
	火人京创(北京)医疗器材		
送 检 单 位	有限公司	样品数量及规格	320ml (320ml/瓶)
生 产 单 位	南京三盾药业有限公司	样 品 性 状	无色液体
生产日期或批号	20190505	接 样 日 期	2019-05-14
检 验 类 别	委托检验	检 验 完 成 日 期	2019-05-30

检验依据: 消毒技术规范(2002年版)

毒理学检验结论:

一次破损皮肤刺激试验结果为无刺激性。

备注: 本报告代替2019年05月31日所发的201900004370报告, 原报告作废。样品名称因客户要求由双极水®消毒液变更为双极水®抗菌液。

授权签字人



2019年9月27日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0317

宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心
检验报告

样品受理编号: 1900088391

报告编号: 201900004370M

第 2 页/共 3 页

一、材料和动物

1. 受试样品:

1.1 样品描述: 双极水®抗菌液。

1.2 样品制备: 原受试物。

2. 动物和饲养环境

来源	桐乡市银海兔业专业合作社	品系	新西兰家兔
种属	家兔	数量	3 只
级别	普通级	实验动物使用许可证号	SYXK（浙）2018-0003
实验动物生产许可证号	SCXK（浙）2018-0002		
饲养环境			
室温范围	21.4℃~23.8℃	相对湿度范围	58.4%~69.8%
采光控制	12 小时明/暗循环	换气	8~10 次/小时
饲料来源	桐乡市银海兔业专业合作社	饮水	自由饮水

二、方法:

试验前将实验动物背部脊柱两侧被毛剪掉,去毛范围各为 3cm×3cm,涂受试物前,在去毛皮肤上,用 75%酒精清洁、消毒暴露皮肤,待酒精挥发后,用灭菌刀片或注射针头在皮区内划一个“井”形的破损伤口,将预先处理好的受试样品贴覆在一侧去毛区并用一层玻璃纸覆盖,再用无刺激性胶布加以固定。另一侧皮肤作为对照。涂敷面积 2.5cm×2.5cm。采用封闭性试验,敷用时间为 4h。4h 后移除贴覆物。

移除受试物后 1h、24h 和 48h 观察贴覆部位皮肤反应,进行皮肤反应评分,以实验动物积分平均值进行综合评价,根据各观察时点的最高积分,进行皮肤刺激强度分级。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0317

宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心
检验报告

样品受理编号: 1900088391

报告编号: 201900004370M

第 3 页/共 3 页

三、试验结果


受试物对家兔一次破损皮肤刺激性试验结果

动物 编号	1h						24h						48h					
	样品			对照			样品			对照			样品			对照		
	红斑	水肿	总分	红斑	水肿	总分	红斑	水肿	总分	红斑	水肿	总分	红斑	水肿	总分	红斑	水肿	总分
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
积分 均值	0			0			0			0			0			0		

四、结论:

受试物对家兔一次破损皮肤刺激试验检验结果为无刺激性, 未见其他毒性。

授权签字人

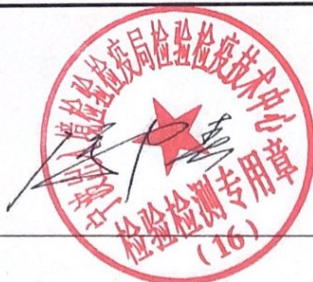

2019 年 9 月 27 日